Pile Dynamics, Inc.
Transducer 536

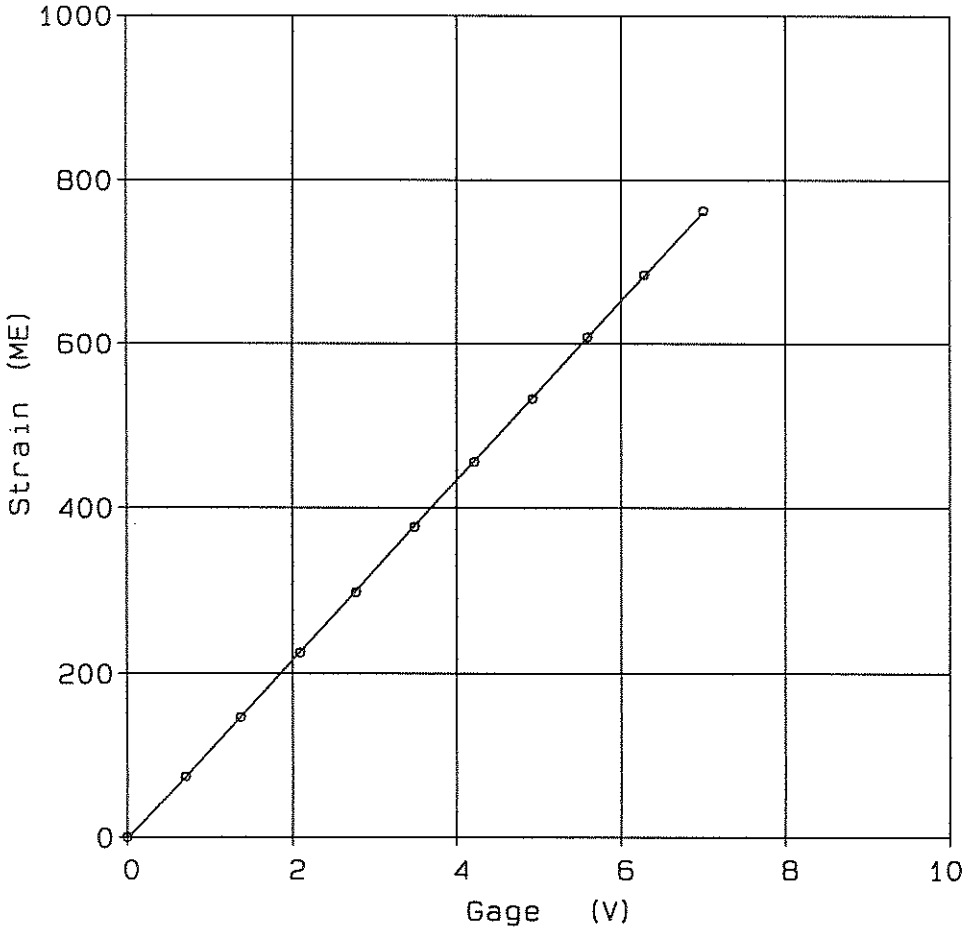

PDA Cal Factor = 109.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 379.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.71
147	1.38
225	2.10
298	2.77
377	3.50
456	4.22
534	4.92
608	5.59
685	6.28
764	7.00

Calibrated by: Jason Dahl

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2