# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 537

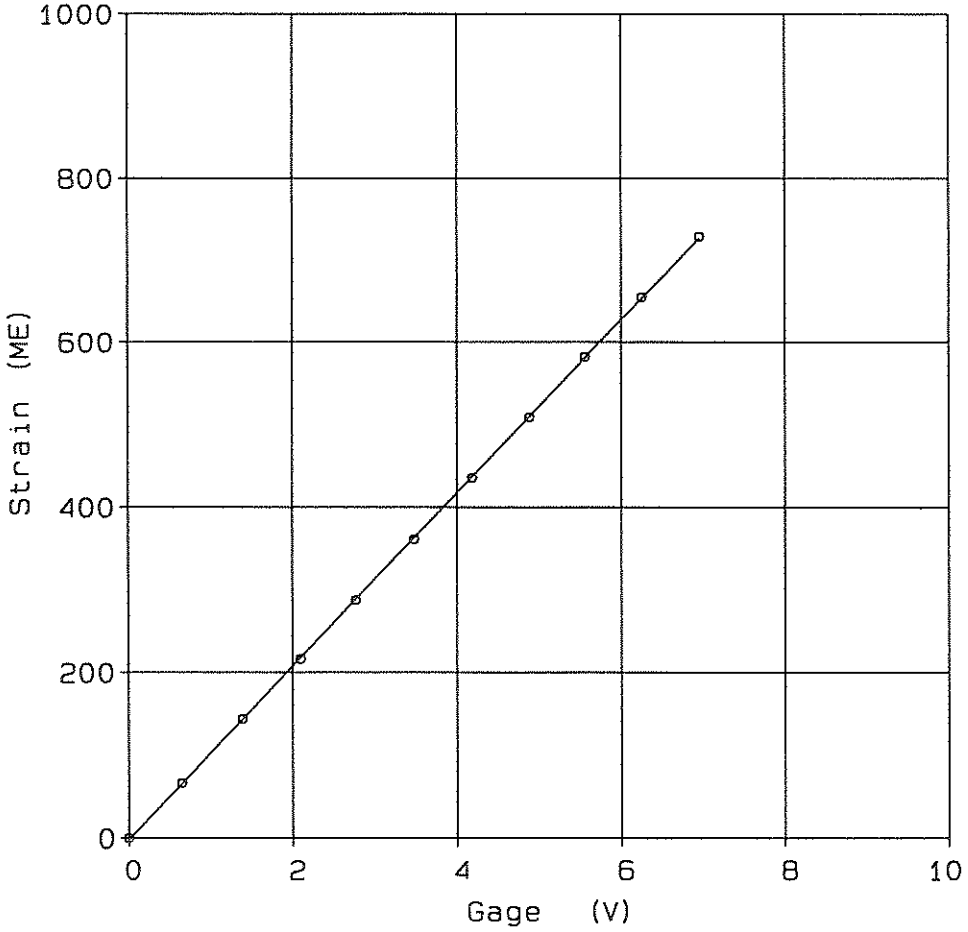


PDA Cal Factor = 105.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 364.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 68 | .66 |
| 144 | 1.40 |
| 217 | 2.10 |
| 287 | 2.77 |
| 361 | 3.48 |
| 435 | 4.18 |
| 510 | 4.88 |
| 582 | 5.56 |
| 656 | 6.25 |
| 730 | 6.95 |

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2