Pile Dynamics Inc
Transducer 538

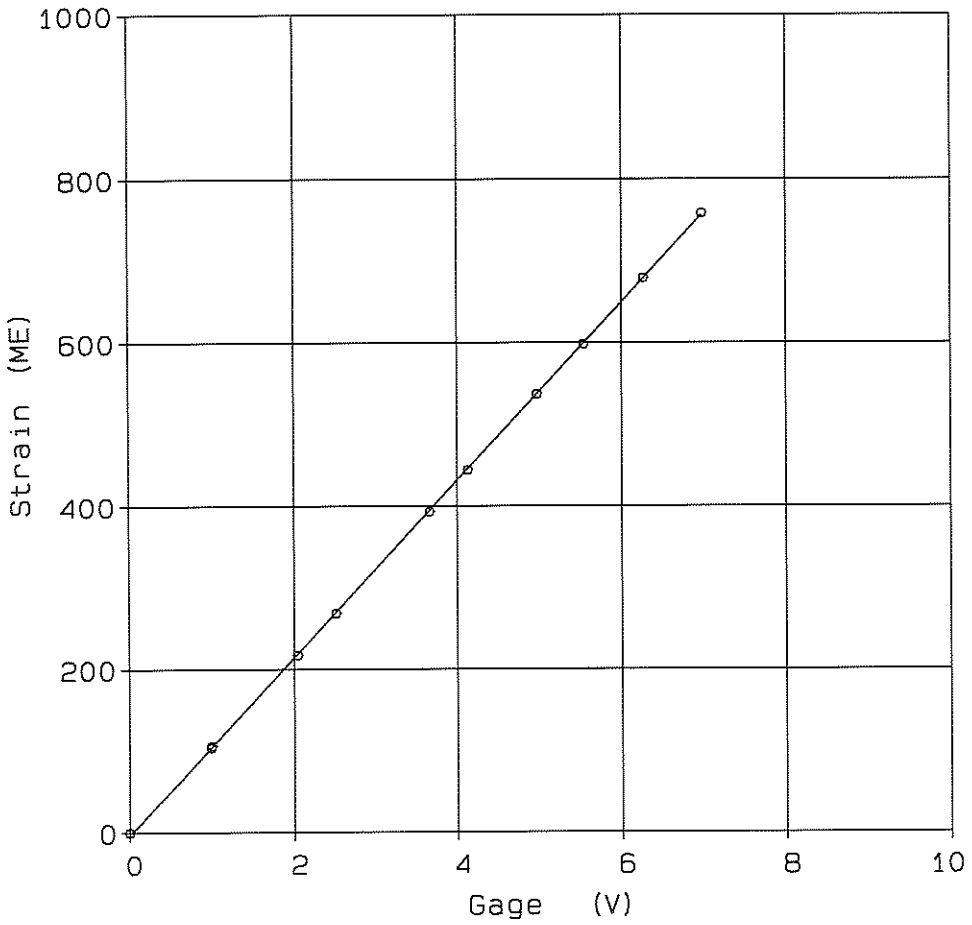

PDA Cal Factor = 108.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 377.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
105	.99
106	1.01
218	2.04
268	2.52
393	3.66
444	4.13
537	4.98
599	5.54
680	6.27
759	6.99

Calibrated by: J. Tarbell

Calibrated on: 27-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2