Pile Dynamics, Inc.
Transducer 539

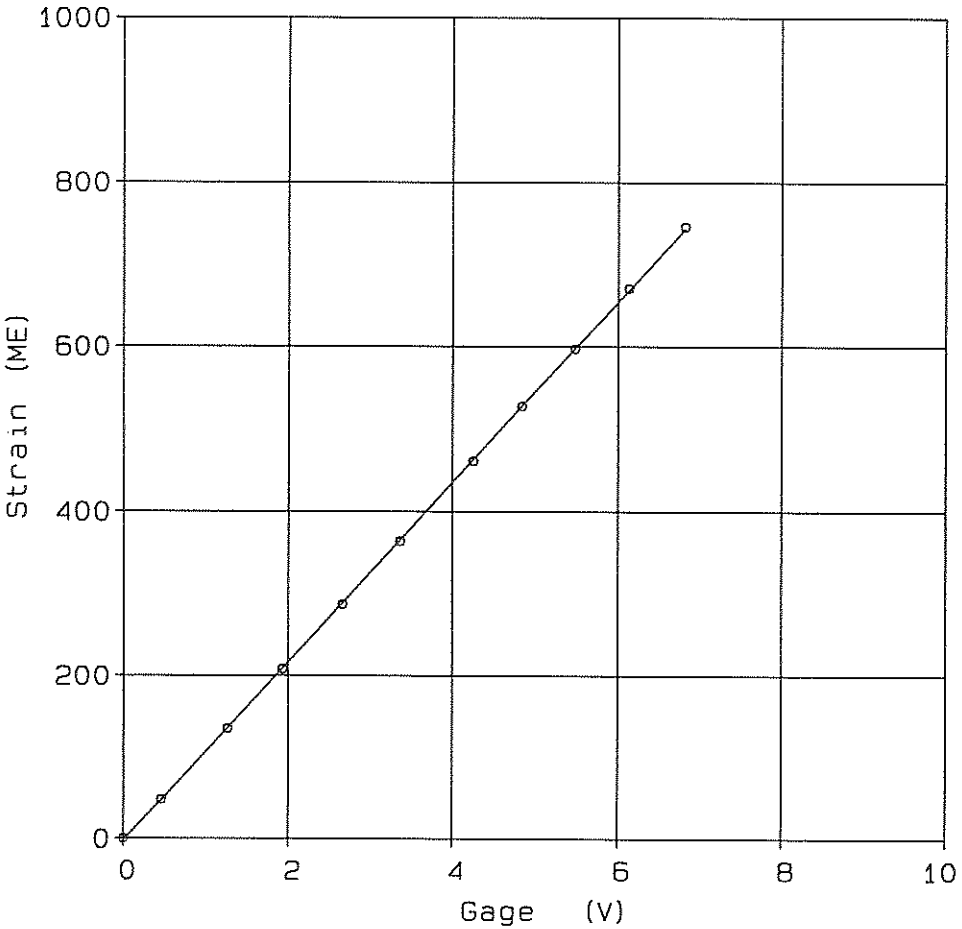

PDA Cal Factor = 109.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 380.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
50	.47
135	1.26
209	1.94
288	2.67
364	3.37
461	4.25
528	4.85
598	5.48
671	6.14
747	6.82

Calibrated by: J. Deutschmann

Calibrated on: 05-APR-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2