Pile Dynamics, Inc.

Transducer 543

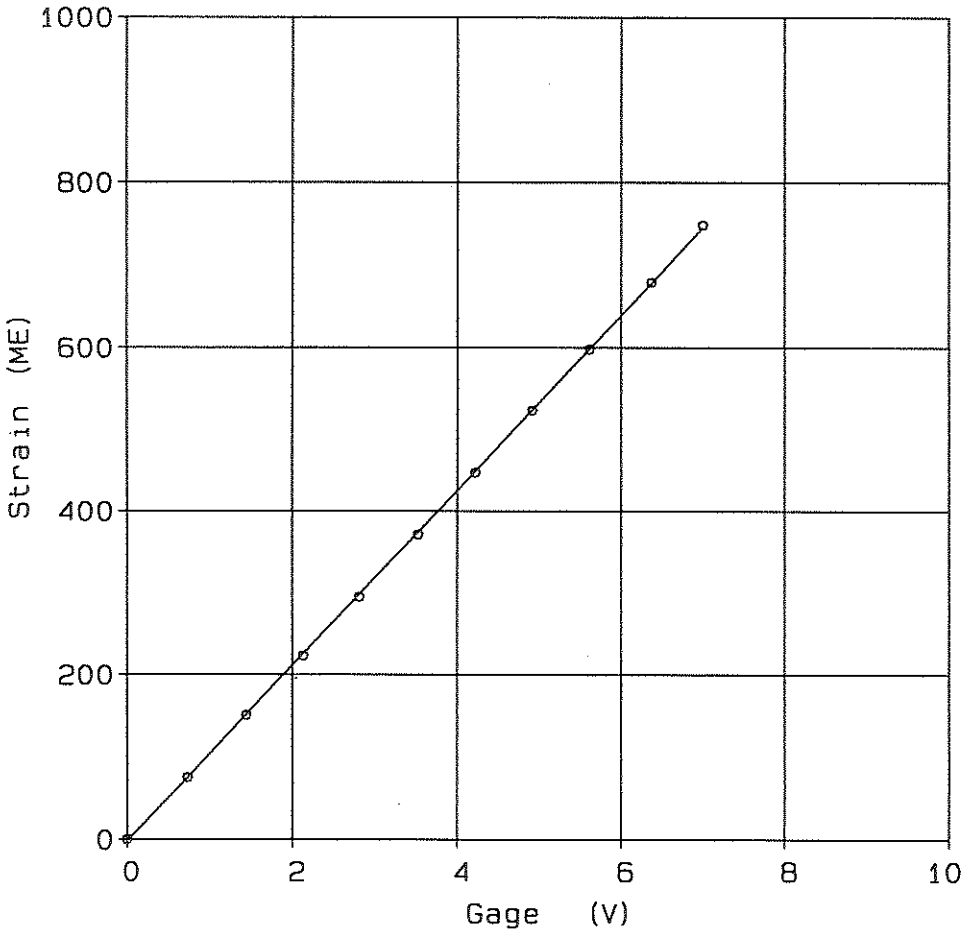

PDA Cal Factor = 107.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 371.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.73
151	1.44
223	2.13
296	2.82
372	3.52
447	4.22
523	4.92
599	5.63
680	6.37
749	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 13-Apo-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2