Pile Dynamics, Inc.
Transducer 546

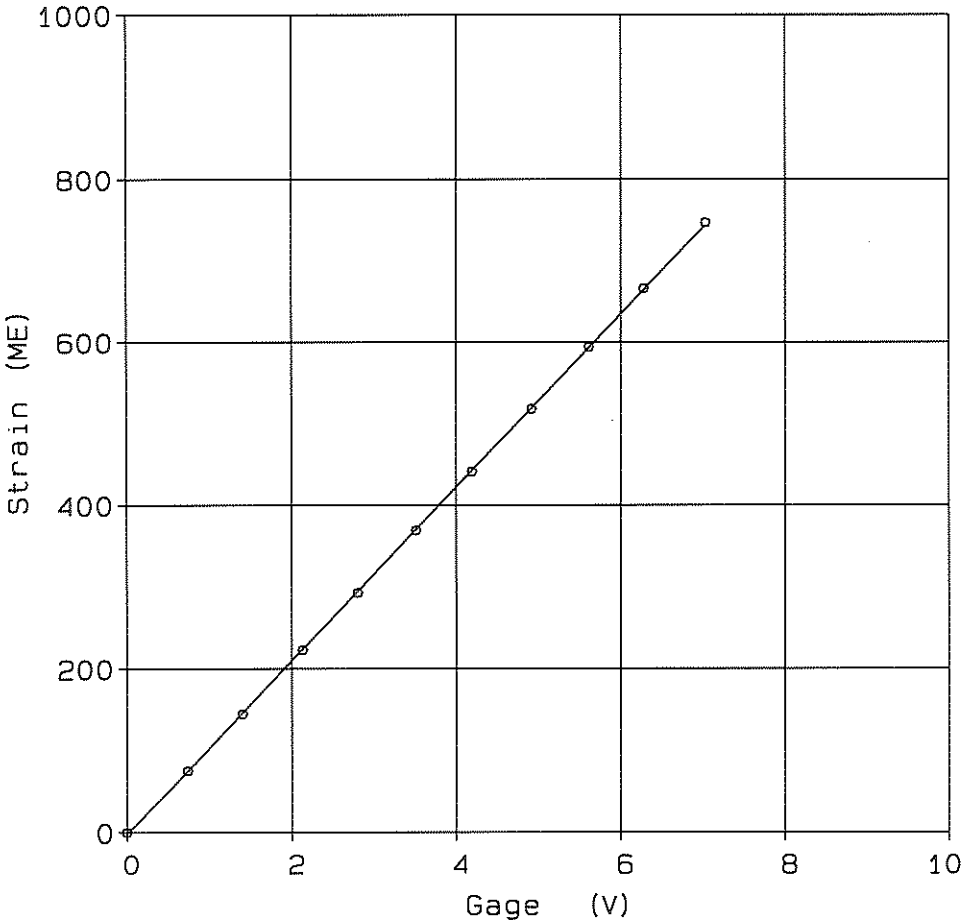

PDA Cal Factor	=	106.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	369.0 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.74
146	1.40
223	2.14
293	2.80
370	3.52
441	4.19
519	4.91
594	5.62
666	6.29
747	7.04

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 13-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2