PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 710 C

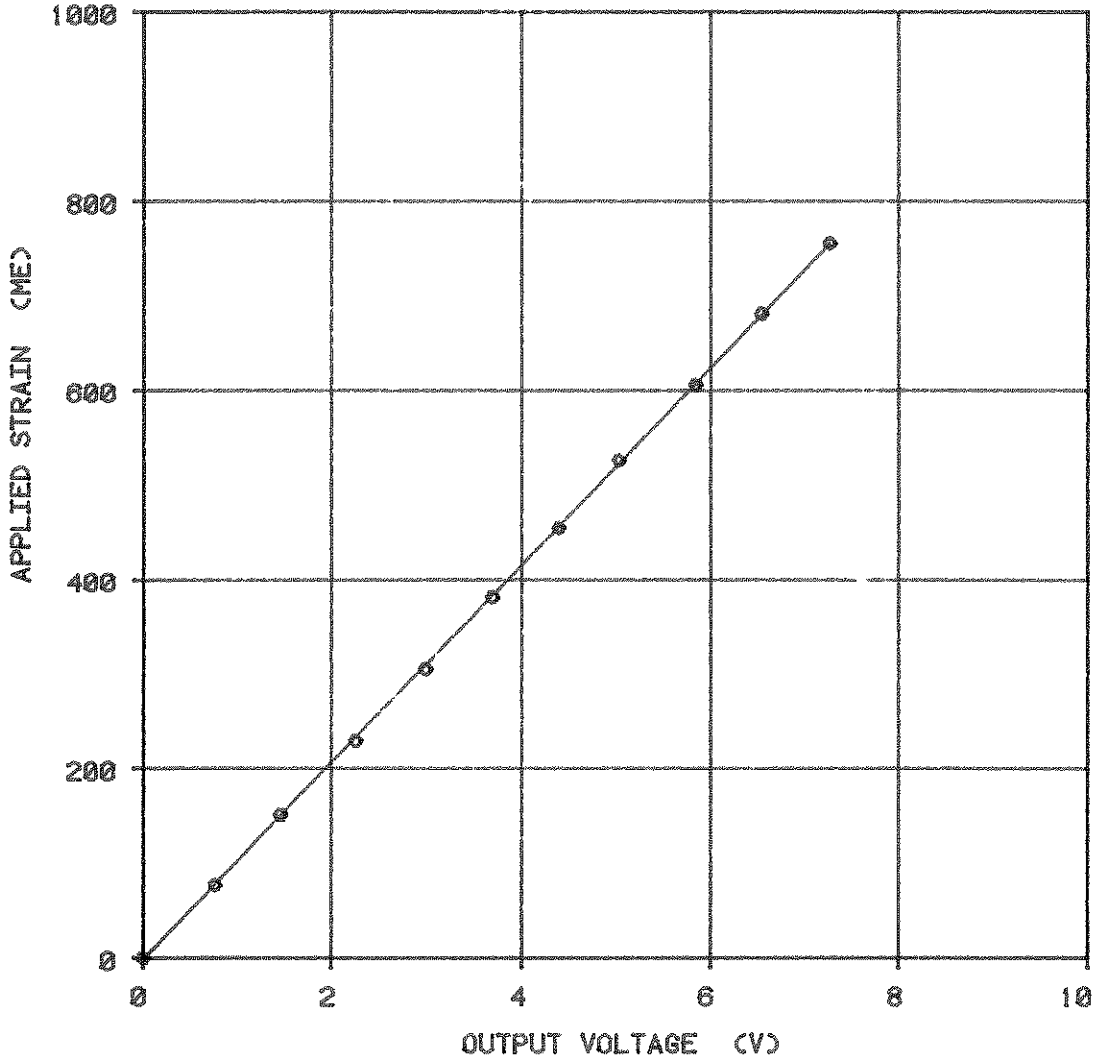

INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 710C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.889	0.761
3	151.005	1.468
4	229.686	2.253
5	305.271	2.983
6	381.151	3.699
7	454.617	4.398
8	526.001	5.031
9	606.130	5.842
10	681.170	6.549
11	756.737	7.265

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.379 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.7095 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED