
Pile Dynamics Inc
Transducer 735C

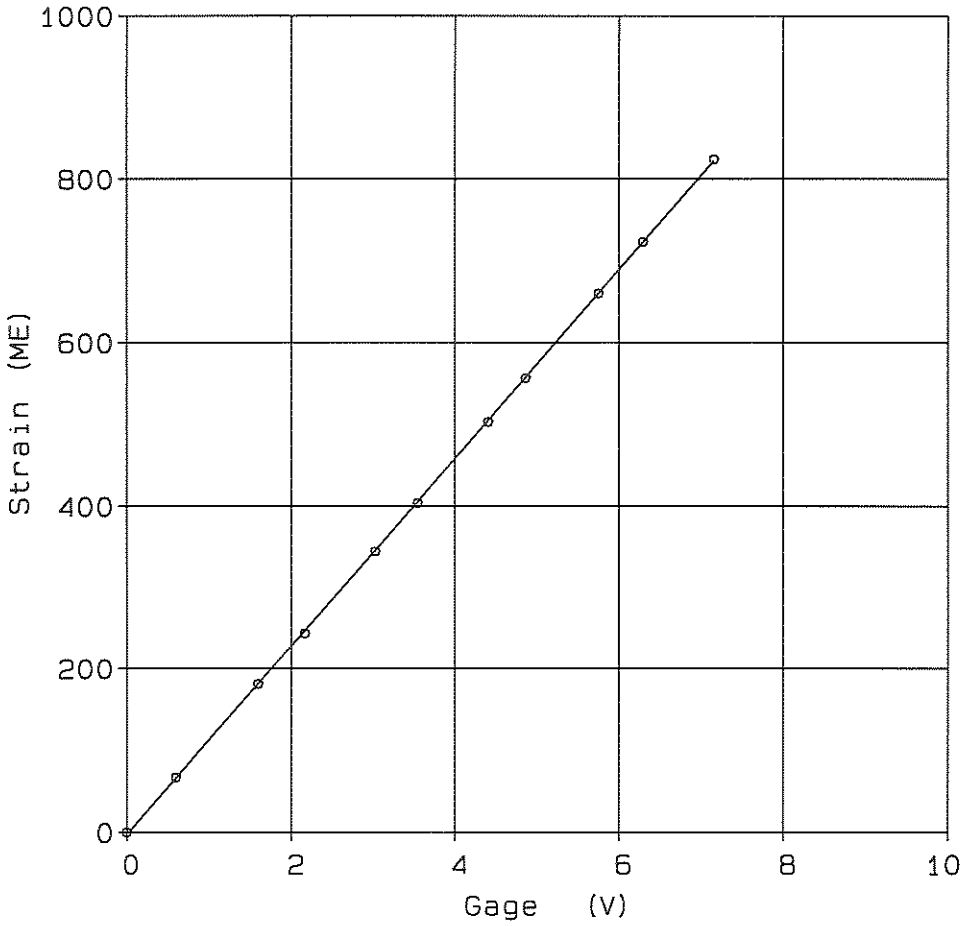

PDA Cal Factor = 115.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 400.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.61
181	1.60
244	2.16
344	3.03
404	3.55
504	4.40
557	4.87
660	5.75
723	6.29
825	7.16

Calibrated by: J. Bartholomew

Calibrated on: 24-Feb-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2